



Nasal Pillows Interface (P6)

Benutzerhandbuch

CE0123

Nasal Pillows Interface (P6)

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für BMC Nasal Pillows Interface (P6) entschieden haben. Die Nasal Pillows Interface ist bequem, flexibel und leise. Sie ist so konzipiert, dass sie Ihr Gesicht so wenig wie möglich berührt, so dass Sie sich während der Therapie wohl fühlen. In diesem Benutzerhandbuch finden Sie die Informationen, die Sie für die korrekte Verwendung Ihrer Maske benötigen.

Die Nasal Pillows Interface (P6) und das Zubehör wurden nicht mit Naturkautschuklatex oder DEHP hergestellt.

Verwendungszweck

Die Nasal Pillows Interface (P6) ist als Schnittstelle für Patienten gedacht, denen eine CPAP- oder Bi-Ebenen-Therapie verordnet wurde.

- für die Anwendung bei erwachsenen Patienten (> 66 lb / 30 kg), für die eine positive Atemwegstherapie verordnet wurde.
- für die Wiederverwendung bei einem Patienten im häuslichen Umfeld und für die Wiederverwendung bei mehreren Patienten im Krankenhaus / institutionellen Umfeld bestimmt.

VORSICHT: In den USA darf dieses Gerät nach dem Bundesgesetz nur von einem Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

Kontraindikationen

Diese Maske sollte bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen mit Vorsicht verwendet werden:

- Gesichtsverformung.
- Verletzte Gesichtshaut, die während der Anwendung mit der Maske in Berührung kommt.

Vor der Verwendung der Maske

WARNUNGEN

- Die Belüftungsöffnungen müssen unbeschädigt und frei von Verstopfungen sein.
- Die Maske ist nicht für Patienten geeignet, die eine lebenserhaltende Beatmung benötigen.

Diese Maske sollte nur mit CPAP- oder Bi-Level-Geräten verwendet werden, die von einem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen wurden.

Die Maske sollte nur verwendet werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sobald die Maske aufgesetzt ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät Luft ausbläst.

Erläuterung: CPAP- und Bi-Level-Geräte sind dazu vorgesehen, mit speziellen Masken (oder Verbindungsstückern) verwendet zu werden, die Belüftungsöffnungen haben, um einen kontinuierlichen Luftstrom aus der Maske zu ermöglichen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, wird die Atemluft mit der Frischluft aus dem Gerät durch die Belüftungsöffnungen der Maske ausgestoßen. Wenn das Gerät jedoch nicht in Betrieb ist, reicht die über die Maske zugeführte Frischluft nicht aus, und die ausgetauschte Luft kann wieder eingetauscht werden. Das erneute Einatmen der ausgetauschten Luft über mehrere Minuten hinweg kann unter Umständen zum Ersticken führen. Dies gilt für die meisten Modelle von CPAP- oder Bi-Level-Geräten.

Bei niedrigem CPAP-Druck kann der Fluss durch den Ausatmungsanschluss unzureichend sein, um das gesamte ausgeatmete Gas aus dem Schlauch zu entfernen. Es kann zu einer gewissen Rückatmung kommen.

Um das Risiko des Erbrechens während des Schlafs zu minimieren, sollte der Patient drei Stunden vor der Anwendung der Maske weder essen noch trinken. Diese Maske wird nicht empfohlen, wenn der Patient ein verschreibungspflichtiges Medikament einnimmt, das Erbrechen verursachen kann.

Nicht geeignet für Benutzer mit Silikonallergie.

Diese Maske sollte nicht bei Patienten verwendet werden, die unkooperativ, bewusstlos oder nicht ansprechbar sind oder die Maske nicht abnehmen können.

Die Verwendung der Maske kann Zahnschmerzen, Zahnfleischschmerzen oder Kieferbeschwerden verursachen oder bestehende Zahnerkrankungen verschlimmern. Wenden Sie sich bei Auftreten dieser Zustände an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Wenn der Patient nicht dazu instande ist, die Maske selbst abzunehmen, muss die Maske unter qualifizierter Aufsicht verwendet werden.

Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff.

Der Sauerstofffluss muss abgeschaltet werden, wenn der CPAP- oder das BiLevel-Gerät nicht in Betrieb sind, damit sich kein ungenutzter Sauerstoff innerhalb des Gerätgehäuses ansammelt und eine Brandgefahr entsteht.

Der Sauerstoff unterstützt die Verbrennung. Der Sauerstoff darf nicht beim Rauchen oder in Gegenwart einer offenen Flamme verwendet werden. Verwenden Sie Sauerstoff nur in gut belüfteten Räumen.

Bei einer festen Durchflussrate des zusätzlichen Sauerstoffflusses variiert die eingetauschte Sauerstoffkonzentration je nach Druckeinstellungen, Atemmuster des Patienten, Maske, Applikationsstelle und Leckagenrate.

Die technischen Spezifikationen der Maske werden Ihrem Arzt zur Verfügung gestellt, damit er prüfen kann, ob sie mit dem Fluss-Generator kompatibel ist. Wird die Maske außerhalb der technischen Spezifikationen oder mit inkompatiblen Geräten verwendet, kann dies die Dichtigkeit und den Komfort der Maske beeinträchtigen, eine optimale Therapie kann nicht erreicht werden, und Leckagen oder Schwankungen in der Leckagerate können die Funktion des Fluss-Generators beeinträchtigen.

Stellen Sie die Verwendung der Maske ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Schlaftherapeuten, wenn Sie IRGENDEINE unerwünschte Reaktion auf die Verwendung der Maske haben.

Einzelheiten zu den Einstellungen und zur Bedienung finden Sie im Handbuch Ihres CPAP- oder BiLevel-Geräts.


Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie die Maske verwenden.

Die hier gezeigten Abbildungen sind lediglich indikativ. Bei es Unstimmigkeiten zwischen der Abbildung und dem tatsächlichen Produkt gibt, ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sollten BMC und den zuständigen Behörden in Ihrem Land gemeldet werden.

Die Häufigkeit der Reinigung, die Reinigungsmethoden oder die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht in den Begleitdokumenten angegeben sind, oder die Überschreitung der Anzahl der Aufbereitungszyklen können sich negativ auf die Maske und damit auf die Sicherheit oder die Qualität der Therapie auswirken.


Bestandteile der Maske

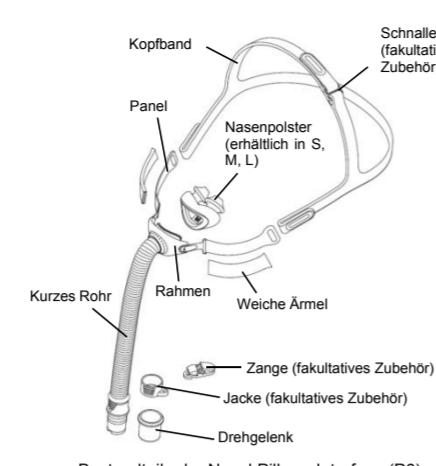


Anlegen der Maske



Das Zerlegen der Maske

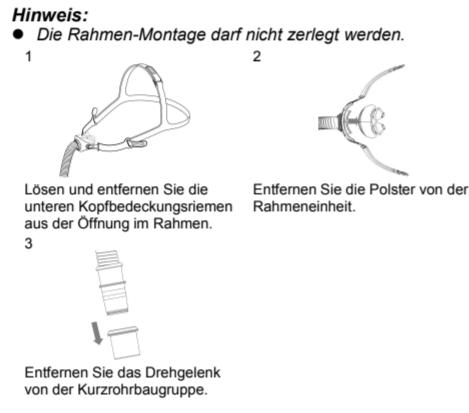

Erneute Montage der Maske

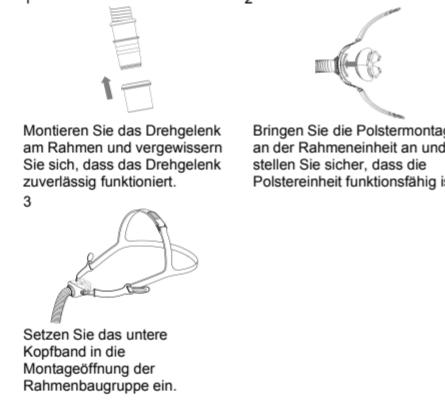

Reinigen der Maske zu Hause

Anmerkungen:

- Die Maske und die Kopfband können nur durch Handwasche gereinigt werden.
- Entfernen Sie beim Reinigen nicht die weichen Hülsen.

VORSICHT

- Verwenden Sie keine Lösungen, die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aromastoffe, Feuchtigkeitsspender, antibakterielle Mittel oder Duftöle enthalten, um irgendeinen Bestandteil der Maske zu reinigen. Diese Lösungen können Schäden verursachen und die Nutzungsdauer des Produkts reduzieren.
- Directe Sonneneinstrahlung oder Hitze auf irgendeinen Bestandteil der Maske kann zu Funktionsstörungen führen.
- Visuelle Kriterien für die Produktkontrolle: Bei sichtbarer Beschädigung eines Maskenteils (Risse, Sprünge, Risse usw.) sollte das Teil entsorgt und ersetzt werden.
- Der Austausch von Teilen sollte von Fachpersonal durchgeführt werden.

Vorbereitungen vor der Reinigung

- Bereiten Sie Werkzeuge vor: Bürste mit weichen Borsten, Wasser in Trinkwasserqualität (10 Liter pro Maske), mildes Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt).
- Demontieren Sie die Masken-Bestandteile entsprechend der Demontageanleitung.

Täglich / nach jeder Anwendung

- Weichen Sie die Bestandteile 10 Minuten lang in einer Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkwasserqualität (25°C bis 35°C) auf.
- Reinigen Sie während des Einweichens jedes Teil 1 Minute lang mit einer Bürste mit weichen Borsten. Achten Sie besonders auf alle Ritzeln und Hohlräume.
- Schütteln Sie die Bestandteile zweimal kräftig in Wasser mit Trinkwasserqualität, jeweils 5 Liter Wasser pro Maske.
- Lassen Sie die Bestandteile an der Luft trocknen und vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn alle Bestandteile trocken sind, setzen Sie die Maske gemäß den Montageanweisungen wieder zusammen.

Hinweis:

- Einmal täglich oder nach jedem Gebrauch gereinigt, kann die Maske bis zu 365 Mal gewaschen werden.

Wöchentlich

Waschen Sie das Kopfband und seine Bestandteile 10 Minuten lang von Hand in einer Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkwasserqualität (25°C bis 35°C). Spülen Sie das Kopfband und ihre Bestandteile gut mit Wasser von Trinkwasserqualität ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Hinweis:

- Einmal pro Woche gereinigt, kann das Kopfband bis zu 52 Mal gewaschen werden.

Wiederaufbereitung der Maske zwischen Patienten

Diese Maske sollte bei der Verwendung zwischen Patienten wieder aufbereitet werden. Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen sind auf der BMC-Website verfügbar, www.bmc-medical.com. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BMC-Verteiler.

Hinweis:

- Die maximale Anzahl der Desinfektionszyklen beträgt 20.

Fehlersuche

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Die Maske wurde möglicherweise falsch aufgesetzt oder ist nicht richtig eingestellt.	Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Abschnitt „Anlegen der Maske“. Achten Sie darauf, dass das Kopfband nicht zu fest angezogen ist.	
Die Maskengröße ist falsch.	Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt.	
Die Maske ist nicht korrekt angezogen.	Ziehen Sie die oberen und unteren Riemens des Kopfbandes fest.	
Die Polster sind falsch ausgerichtet oder faltig im Gesicht.	Vergewissern Sie sich, dass die Polster gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Erneute Montage der Maske“ korrekt ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die Polster keine Falten aufweisen.	
Die Maskenpolster können verschmutzt sein.	Reinigen Sie die Polster gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen der Maske zu Hause“.	
Die Maske ist falsch montiert.	Montieren Sie die Maske erneut.	
Die Maske ist laut.	Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen der Maske zu Hause“.	

Beabsichtigter klinischer Nutzen

- Verbesserung der Patienten-Schlafqualität.
- Verbesserung der Einhaltung der Therapie der Patienten.

Lagerung

Vergewissern Sie sich, dass die Maske gründlich sauber und trocken ist, bevor Sie sie für längere Zeit aufbewahren. Lagern Sie die Maske an einem trockenen Ort und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.


Entsorgung

Die Maske enthält keine Gefahrenstoffe und kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bei Patienten mit übertragbaren Krankheiten muss das Produkt als medizinischer Abfall entsorgt werden, da es sonst die Verbreitung von Krankheiten verursachen kann.

Nutzungsdauer

Der Nutzungsdauer der Nasal Pillows Interface (P6) hängt von der Nutzungssituation, der Wartung sowie den Umweltbedingungen ab, denen die Maske ausgesetzt ist oder gelagert wird. Da dieses Maskensystem und seine Komponenten modular aufgebaut sind, wird empfohlen, dass der Benutzer es regelmäßig pflegt und inspiziert. Er sollte das Maskensystem oder einzelne Komponenten bei Bedarf oder gemäß den „Visuellen Kriterien für die Produktkontrolle“ im Abschnitt „Reinigen der Maske zu Hause“ dieses Handbuchs austauschen. Die Maske sollte innerhalb von 12 Monaten nach der ersten Verwendung ersetzt werden.

Technischen Spezifikationen

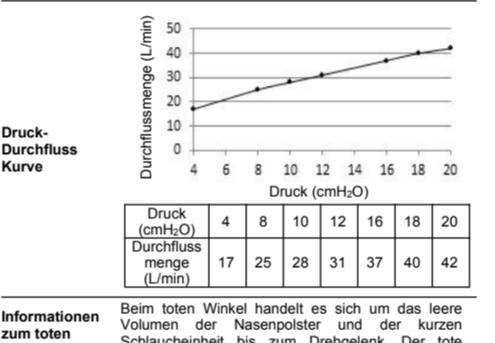

Informationen zum toten Winkel	Beim toten Winkel handelt es sich um das leere Volumen der Nasenpolster und der kurzen Schlaucheinheit bis zum Drehgelenk. Der tote Winkel des P6 für große Polster beträgt 92 ml.
Therapie-Druck	4 bis 20 cmH ₂ O

Widerstand	Gemessener Druckabfall (Durchschnitt für 3 Größen)
bei 50 L/min: 0,4 cmH ₂ O	bei 100 L/min: 1,4 cmH ₂ O
bei 100 L/min: 1,4 cmH ₂ O	

TON	ERKLÄRTE DOPPELNUMMER-LÄRMEMISSIONSWERTE gemäß ISO 4871. Der A-bewertete Schallleistungspegel der Maske beträgt 26 dB(A), mit einer Ungewissheit von 3 dB(A). Der A-bewertete Schalldruckpegel der Maske in einem Abstand von 1 m beträgt 18 dB(A), mit einer Ungewissheit von 3 dB(A).
	Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C (41°F bis 104°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0% bis 93% relative nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit Lager- und Transporttemperatur: -20°C bis +55°C (-4°F bis 131°F) Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport: 0% bis 93% relative nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit

Herstellungsdat	Siehe Produktetikett

Symbole

Soluzione dei Problemi

Problema	Ragione Possibile	Soluzione Possibile
La maschera non tiene oppure è scomoda.	La maschera è stata posizionata o regolata in modo errato.	Seguire attentamente le istruzioni della sezione "Applicazione di Nasal Pillows Interface". Assicurarsi che il copricapo non sia troppo stretto.
	La misura della maschera è sbagliata.	Consultare il medico.
	La maschera non è serrata correttamente.	Serrare la cinghia del copricapo superiore e quella inferiore.
	I cuscini non sono allineati correttamente o risultano piegati sul volto.	Verificare che i cuscini siano correttamente allineati secondo le istruzioni contenute in "Rimontaggio della maschera". Assicurarsi che l'imbottitura non presenti delle pieghe.
	I cuscini della maschera potrebbero essere sporchi.	Pulire i cuscini e secondo le istruzioni contenute in "Pulizia domestica della maschera".
	La maschera è montata in modo errato.	Rimontare la maschera.
La maschera è eccessivamente rumorosa.	Le aperture di sfogo sono completamente o parzialmente ostruite.	Pulire i fori di ventilazione secondo le istruzioni della sezione "Pulizia domestica di Nasal Pillows Interface".

Beneficio Clinico Previsto

- Miglioramento della qualità del sonno del paziente.
- Miglioramento della conformità del paziente al trattamento.

Stoccaggio

Verificare che la maschera sia completamente pulita e asciutta prima di riportarla per qualsiasi periodo di tempo. Conservare la maschera in luogo asciutto evitando l'esposizione diretta ai raggi del sole.

Smaltimento

La maschera non contiene sostanze pericolose e può essere smaltita nei normali rifiuti domestici. Per pazienti affetti da malattie contagiose, il prodotto deve essere smaltito come rifiuto medico, in caso contrario potrebbe causare la diffusione della malattia.

Durata in Servizio

La durata della maschera dipende da intensità di utilizzo, manutenzione e condizioni ambientali in cui la maschera viene utilizzata o conservata. Poiché il sistema maschera e i suoi componenti sono di natura modulare, si consiglia all'utente di sottoporlo a manutenzione e ispezionarlo regolarmente e di sostituirlo il sistema maschera o qualsiasi componente se ritenuto necessario o in base ai "Criteri visivi per l'ispezione del prodotto" riportati nella sezione "Pulizia della maschera a casa" di questo manuale. La maschera deve essere sostituita entro 12 mesi dalla data del primo utilizzo.

Specifiche Tecniche

Curva Pressione-Flusso	Pressione (cmH ₂ O)	Portata del flusso (L/min)
	4	17
	8	25
	10	28
	12	31
	16	37
	18	40
	20	42

Informazioni su spazio morto	Lo spazio morto è il volume vuoto delle cuscini nasali e del tubo corto fino alla girella. Lo spazio morto di P6 per cuscino grande è di 92 mL.
Pressione terapia	Da 4 a 20 cmH ₂ O
Resistenza	Calo di pressione misurato (media per 3 taglie) a 50 L/min: 0,4 cmH ₂ O a 100 L/min: 1,4 cmH ₂ O
Rumorosità	VALORI DI EMISSIONE SONORA A DOPPIA CIFRA DICHIARATI in conformità a ISO 4871. Il livello di potenza sonora ponderato A è pari a 26 dBA, con valore di incertezza di 3 dBA. Il livello di pressione sonora ponderato A della maschera ad una distanza di 1 m è pari a 18 dBA, con un valore di incertezza di 3 dBA.
Condizioni ambientali	Temperatura d'esercizio: Da +5°C a +40°C (Da 41°F a 104°F) Umidità d'esercizio: Da 0% a 93% umidità relativa senza condensa Stoccaggio e trasporto temperatura: Da -20°C a +55°C (Da -4°F a 131°F) Unità di stoccaggio e trasporto: Da 0% a 93% umidità relativa senza condensa
Data di produzione	Vedere l'etichetta del prodotto

Simboli

Sistema e Imballaggio

	Attenzione		Data di scadenza
	Rappresentante e autorizzato nella Comunità Europea		Non prodotto con lattice o gomma naturale
	Codice del lotto		Importatore
	Número de catálogo		Número de modelo
	Limite di temperatura		Produto in China
	Limite di umidità		Dispositivo medico
	Produttore		Identificatore unico del dispositivo

Garanzia Limitata

Si garantisce che la Nasal Pillows Interface (P6), incluso l'assieme della struttura, Cuscini nasali, Attacco, Fibbia e Copricapo saranno esenti da difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto da parte del consumatore iniziale. Per far valere i diritti risultanti dalla presente garanzia contattare i rivenditori locali autorizzati.

PRODUTTORE:
BMC MEDICAL CO., LTD.
Stanza 110 Torre A Edificio Fengyu, via Fucheng n. 115, Haidian, 100036 Beijing, REPUBBLICA POPOLARE CINESE
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Tel: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PER L'UE:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80, 20537 Amburgo, Germania
Tel.: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

Nasal Pillows Interface (P6)
Manual do Utilizador

CE 0123

Nasal Pillows Interface (P6)

Obrigado por escolher a Nasal Pillows Interface (P6) da BMC. A Interface de Almofadas Nasais é confortável, flexível e silenciosa. Foi concebido para minimizar o contacto com o seu rosto, garantindo assim que se senta confortável durante a terapia. Este manual do utilizador fornece-lhe as informações necessárias para a utilização correta da sua máscara. A Nasal Pillows Interface (P6) e os acessórios não são feitos com latex ou borracha natural nem DEHP.

Utilização Pretendida

A Nasal Pillows Interface (P6) destina-se a fornecer uma interface para doentes que foram prescritos com terapia CPAP ou de dois níveis.

- a ser utilizada por doentes adultos (> 66 lb / 30 kg) para os quais tenha sido prescrita terapia de pressão positiva nas vias respiratórias.
- a ser reutilizada por um único doente em ambiente doméstico e por vários doentes em ambiente hospitalar/institucional.

CUIDADO: Nos EUA, a lei federal restringe a venda deste dispositivo por ou sob a ordem de um médico.

Contra-indicações

Esta máscara deve ser utilizada com precaução em doentes com as seguintes condições:

- Defeitura facial.
- Pele facial ferida que entrará em contacto com a máscara durante a utilização.

Antes de Utilizar a Máscara

ADVERTÊNCIAS

- Os orifícios de ventilação devem ser mantidos intactos e livres de obstruções.
- A máscara não é adequada para doentes que necessitem de ventilação de suporte de vida.
- Esta máscara deve ser usada apenas com dispositivos CPAP ou de dois níveis recomendados por um médico ou terapeuta respiratório.
- A máscara não deve ser utilizada se o dispositivo não estiver ligado. Quando a máscara estiver colocada, certifique-se de que o dispositivo está a soprar ar.
- Explicação:** Os dispositivos CPAP ou de dois níveis destinam-se a ser utilizados com máscaras especiais (ou conectores) que possuem orifícios de ventilação para permitir o fluxo contínuo de ar para fora da máscara. Quando o dispositivo está ligado e a funcionar correctamente, o ar fresco do dispositivo liberta o ar exalado através dos orifícios de ventilação da máscara. No entanto, quando o dispositivo não está a funcionar, o ar fresco fornecido através da máscara é insuficiente e o ar exalado pode voltar a ser inalado. A reinalação do ar exalado durante mais de alguns minutos pode, em algumas circunstâncias, provocar asfixia. Isto aplica-se à maioria dos modelos de dispositivos CPAP ou de dois níveis.

- Em baixas pressões de CPAP, o fluxo através da porta de exalação pode ser inadequado para eliminar todo o gás exalado do tubo. Pode ocorrer alguma reinalação.
- Para minimizar o risco de vómitos durante o sono, o doente deve evitar comer ou beber três horas antes de utilizar a máscara. Esta máscara não é recomendada se o doente estiver a tomar um medicamento prescrito que possa causar vómito.

- Não aplicável a utilizadores com alergia ao silicone.
- Esta máscara não deve ser utilizada em doentes que estão não cooperativos, inconscientes, sem resposta, ou incapazes de remover a máscara.

- A utilização da máscara pode causar dor nos dentes, gengivas ou mandíbula ou agravar as condições dentárias existentes. Se estas condições ocorrerem, consulte o seu profissional de saúde.

- Se o doente não conseguir retirar a máscara sozinho, a máscara deve ser utilizada sob supervisão qualificada.

- Siga todas as precauções quando utilizar oxigénio suplementar.

- O fluxo de oxigénio deve ser desligado quando o dispositivo CPAP ou de dois níveis não estiver a funcionar, para que o oxigénio não utilizado não se acumule na caixa do dispositivo e crie um risco de incêndio.

- O oxigénio favorece a combustão. O oxigénio não deve ser utilizado enquanto se fuma ou na presença de chamas abertas. Utilize o oxigénio apenas em ambientes bem ventilados.

- Com uma taxa fixa de fluxo de oxigénio suplementar, a concentração de oxigénio inalado varia, dependendo das definições de pressão, do padrão de respiração do doente, da máscara, do ponto de aplicação e da taxa de fuga.

- As especificações técnicas da máscara são fornecidas para que o seu clínico verifique se é compatível com o gerador de fluxo. Se for utilizada para além das especificações técnicas ou com dispositivos incompatíveis, a vedação e o conforto da máscara podem não ser eficazes, a terapia ideal pode não ser alcançada e a fuga, ou a variação na taxa de fuga, pode afectar o funcionamento do gerador de fluxo.

- Pare de utilizar a máscara e consulte o seu médico ou terapeuta do sono se tiver QUALQUER reacção adversa à utilização da máscara.

- Consulte o manual do seu dispositivo CPAP ou de dois níveis para obter detalhes sobre as definições e informações operacionais.


- Remova todas as embalagens antes de utilizar a máscara.

- As imagens aqui apresentadas são apenas indicativas. Em caso de incoerência entre a imagem e o produto real, prevalecerá o produto real.

- Qualquer incidente grave relacionado com o produto devem ser comunicados à BMC e às autoridades competentes do seu país.

- A frequência da limpeza, os métodos de limpeza diferentes dos especificados nos documentos de acompanhamento, ou a ultrapassagem do número de ciclos de processamento podem ter um efeito adverso na máscara e, consequentemente, na segurança ou qualidade da terapia.

Componentes da Máscara

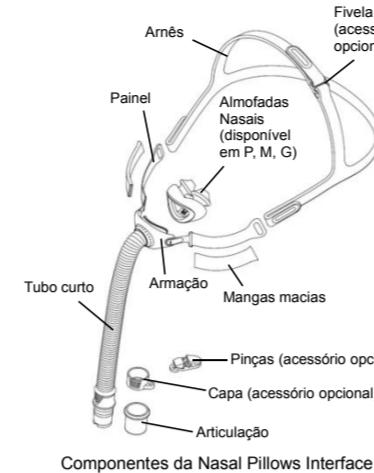

Componentes da Nasal Pillows Interface (P6)


Colocação da Máscara




Desmontagem da Máscara

Nota:

- O Conjunto da armação não pode ser desintegrado.

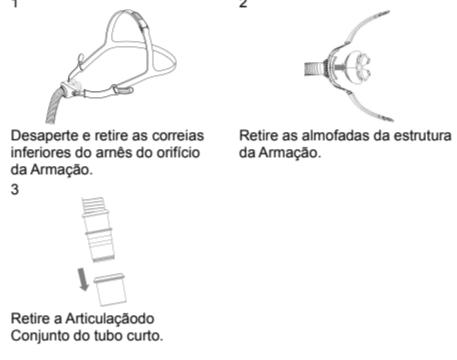

Remontagem da Máscara

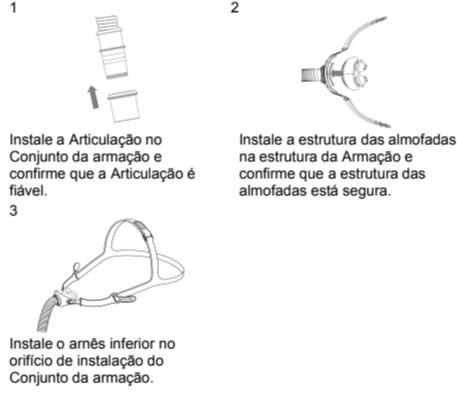

Limpeza da Máscara em Casa

Notas:

- A máscara e o arnês só podem ser limpos através da lavagem das mãos.

- Não remova as mangas macias durante a limpeza.

CUIDADOS

- Não utilize soluções que contenham lixívia, cloro, álcool, aromatizantes, hidratantes, agentes antibacterianos ou óleos perfumados para limpar qualquer parte da máscara. Estas soluções podem causar danos e reduzir a vida útil do produto.
- A exposição de qualquer parte da máscara à luz solar direta ou ao calor pode causar a sua deterioração.
- Critérios visuais para a inspecção do produto: Se houver qualquer deterioração visível de